


03-5


1 300mg 3 6 1

Image



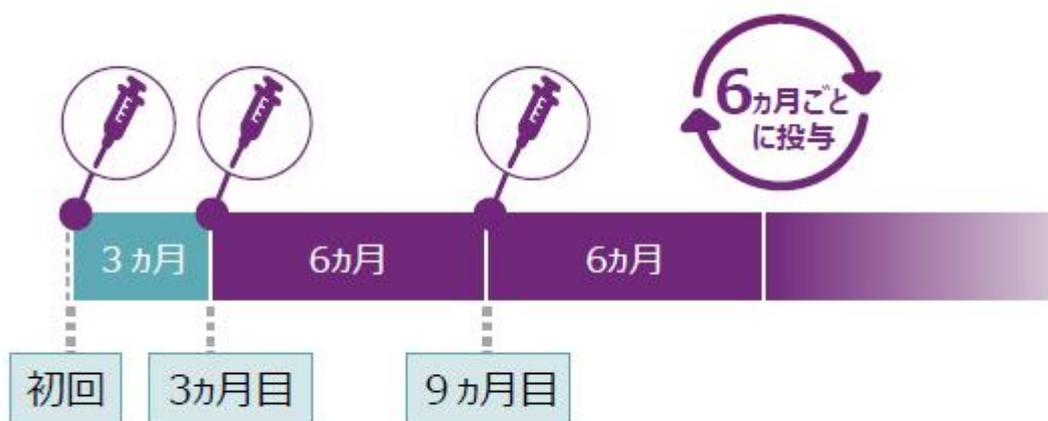


Image

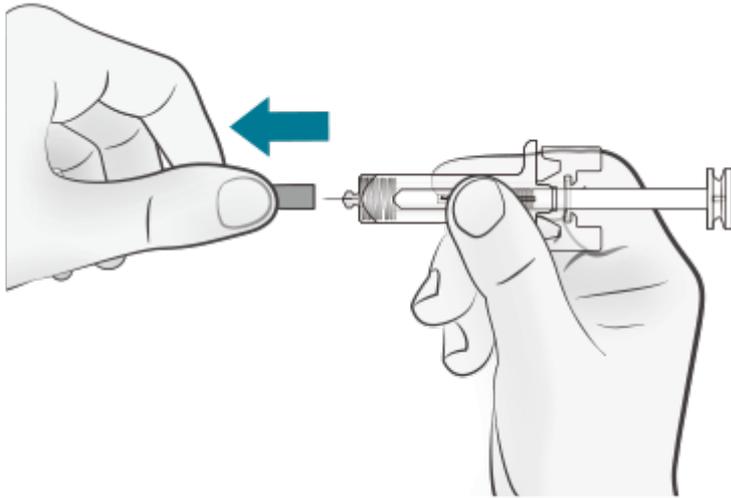

3

45


Image

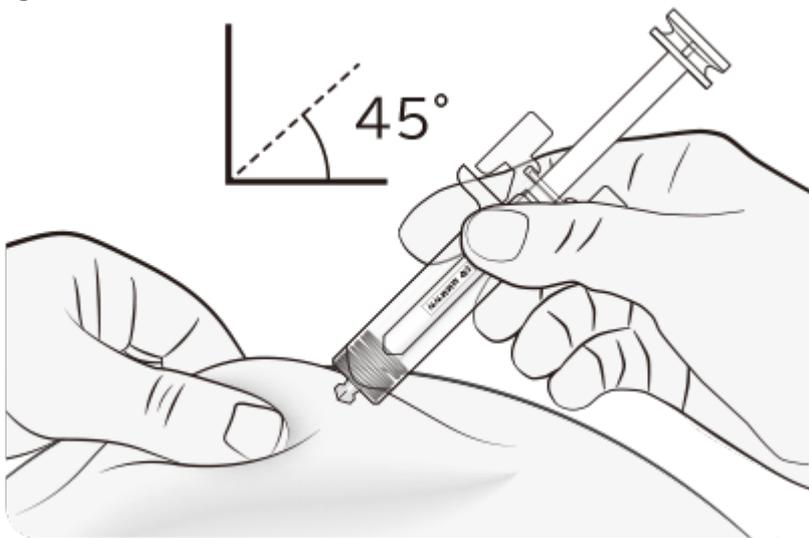

4

Image



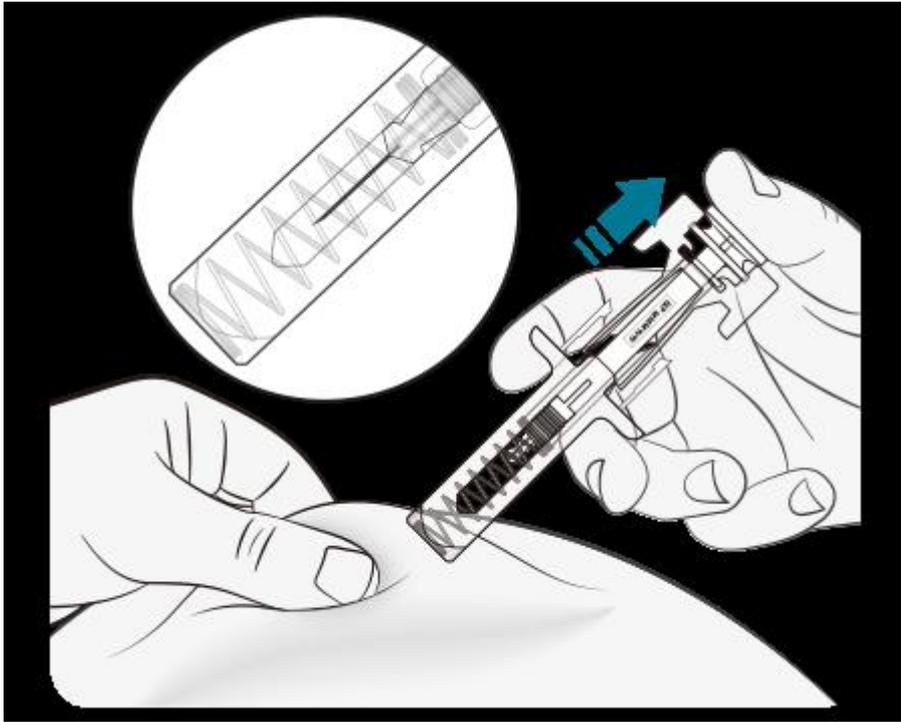


7





### ◆ 当初のスケジュール

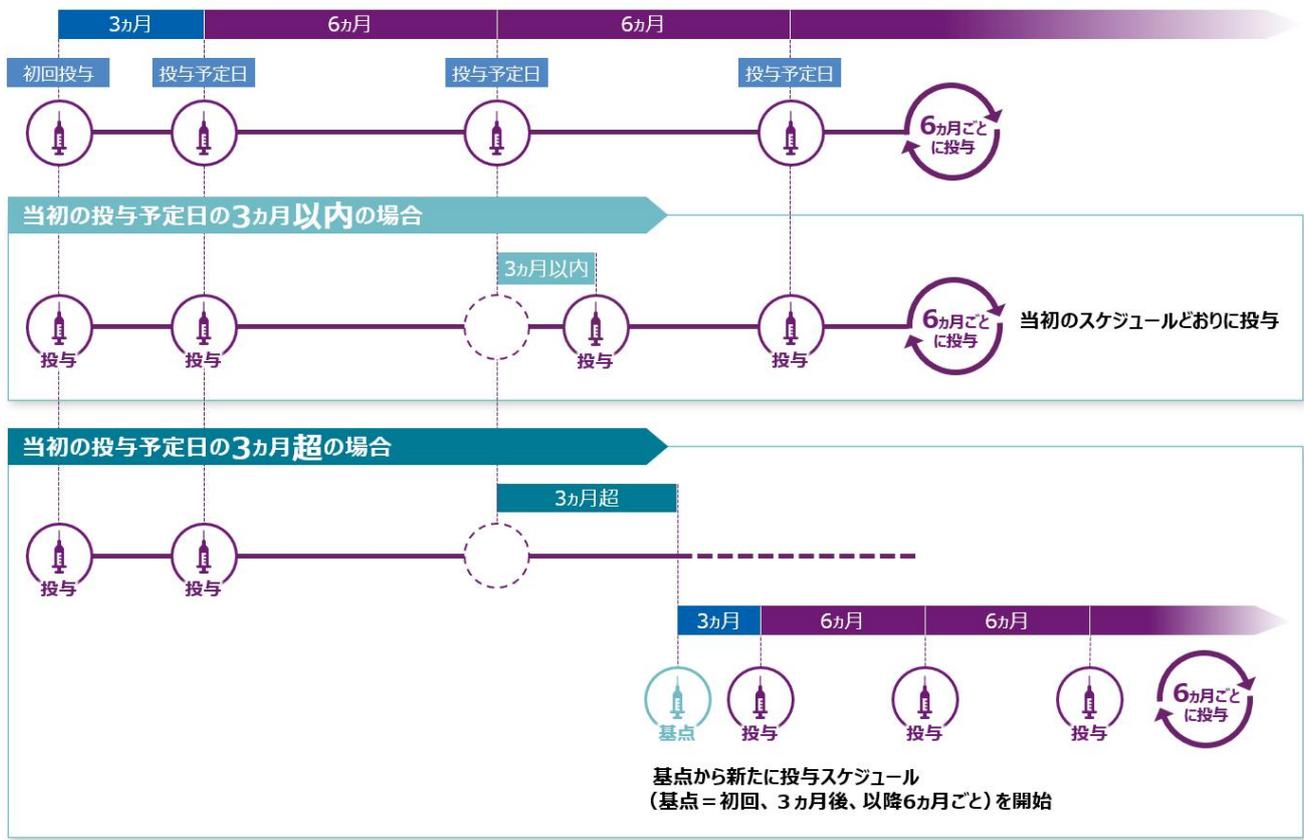

□□□□□□□□□□


- 00000000000000000000000000000000
- 00010000000000000000000000000000
- 00000100000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000

Image



□□□□



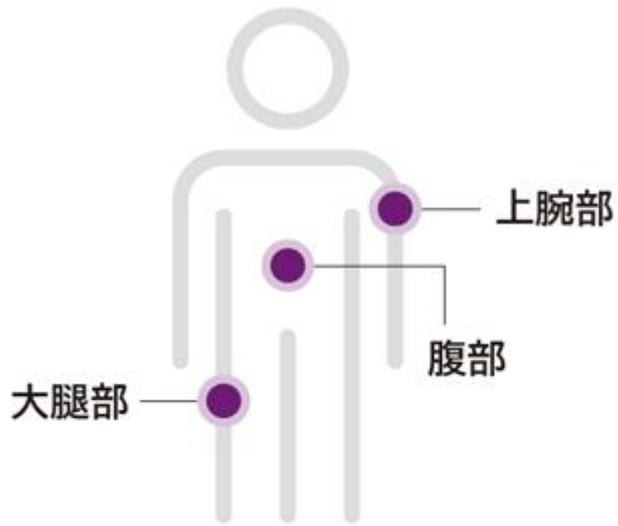

□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

⚠ 本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

**使用前**

- 外箱やプラスチックトレイの封が破れている場合は、プレフィルドシリンジを使用しないでください。
- 注射の準備が整うまで注射針カバーを外さないでください。
- プレフィルドシリンジを硬い所に落とした場合や、注射針カバーを外した後に落とした場合は、使用しないでください。

**使用後**

- プレフィルドシリンジの再使用や分解はしないでください。

薬液確認窓

注射針カバー

針

● プレフィルドシリンジには、注入完了後に注射針を覆う針ガードがついています。この針ガードにより、注射後の針刺し事故を防ぎます。

□□□□□□



**レクビオ<sup>®</sup>皮下注 300mgシリンジ 投与ガイド**

**レクビオの扱いに当たって**

- ※本剤の扱いには必ず、医師・看護師等の医療従事者が行ってください。
- ※本剤は7日間の持ち帰り可能なプレフィルドシリンジです。シリンジは1回のみ使用してください。
- ※本剤は、室温で保存してください。
- ※本剤は、他の一環包装の薬物とは異なります。

**レクビオの投与部位**

- ※本剤は、皮下にのみ投与してください。
- ※注射可能な部位は腹部、上腕部又は大腿部です。

**警告**

セリン・ソルビン酸、安息香酸、液剤保存剤等、  
薬剤中の薬液成分や包装材から有害物質が  
遊離しないようご注意ください。

**プレフィルドシリンジの構造及び名称**

※本剤を使用する前に、以下に記載された重要事項をご確認ください。

- ※本剤はガラスプレフィルドシリンジに  
充填されている薬液は、プレ  
フィルドシリンジと見做して  
扱ってください。
- ※プレフィルドシリンジを破損  
し薬液が漏れ出す際、注射  
針のバーンも同時に破損  
し薬液が漏れ出す場合があります。  
破損した場合は、使用しないで  
ください。
- ※プレフィルドシリンジの構造図  
や重要事項については  
添付資料を必ずご確認ください。

**NOVARTIS**

□□□□□

Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/leqvio/about/administration>